




SD 70
Con


Plaats de batterijen

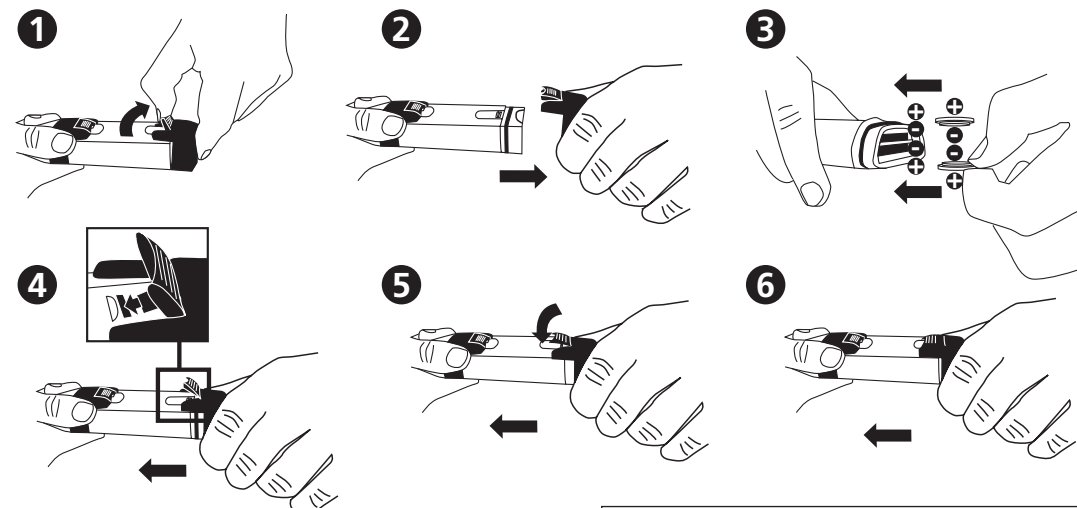

METING

Verwijder de beschermdop van de meetspits

A. Power ON/OFF

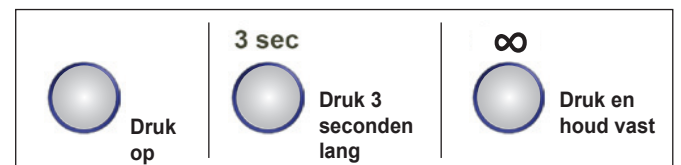

Gaat automatisch uit na 8 minuten zonder activiteit.

B. Vergrendel/ontgrendel



Mogelijk enige vertraging na druk op voordat gegevens worden vastgelegd (!).

C. Achtergrondverlichting



D. Opslaan gegevens



Na 3 sec. verschijnt het bestandsnr. tijdelijk op het display, bijv. 01. Als de max. opslagcapaciteit is bereikt, worden de oudste bestanden overschreven.

CON KALIBRATIE


Tekens in **ROOD** vertegenwoordigen „Knipperende symbolen“.

- Kalibreer opnieuw volgens individuele aanbevelingen! Spoel de elektrode na elke meting af met gedistilleerd water.
- Als de temperatuur buiten bereik is, wordt „ERR“ getoond. Meter keert automatisch terug naar Meetmodus.
- Als de standaard meetwaarde meer dan 30% afwijkt van het standaard bufferbereik, wordt „ERR“ getoond.

E1. Automatische stand

Verwijder de beschermdop van de meetspits.
Zet AAN (zie A)


Autom. herkenning voor Ⓛ : 1413 μS en Ⓜ : 12,88 mS

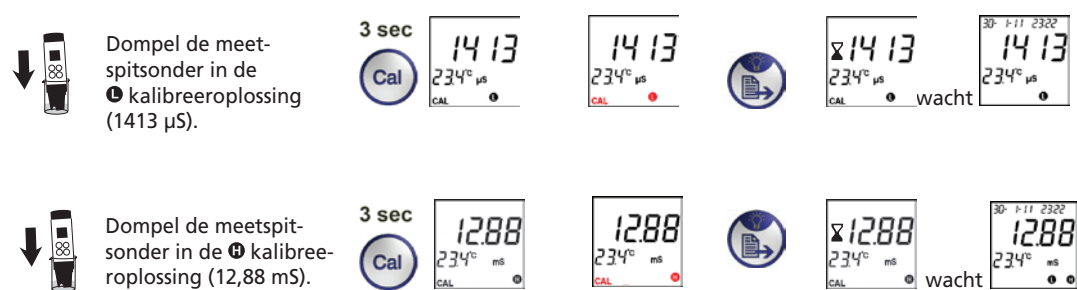

E2. Handbedieningsstand

Verwijder de beschermdop van de meetspits.
Zet AAN (zie A)

Ⓛ : Beperkt tot 200 ~ 2000 μS ; Ⓜ : beperkt tot 2.00 ~ 20.00 mS

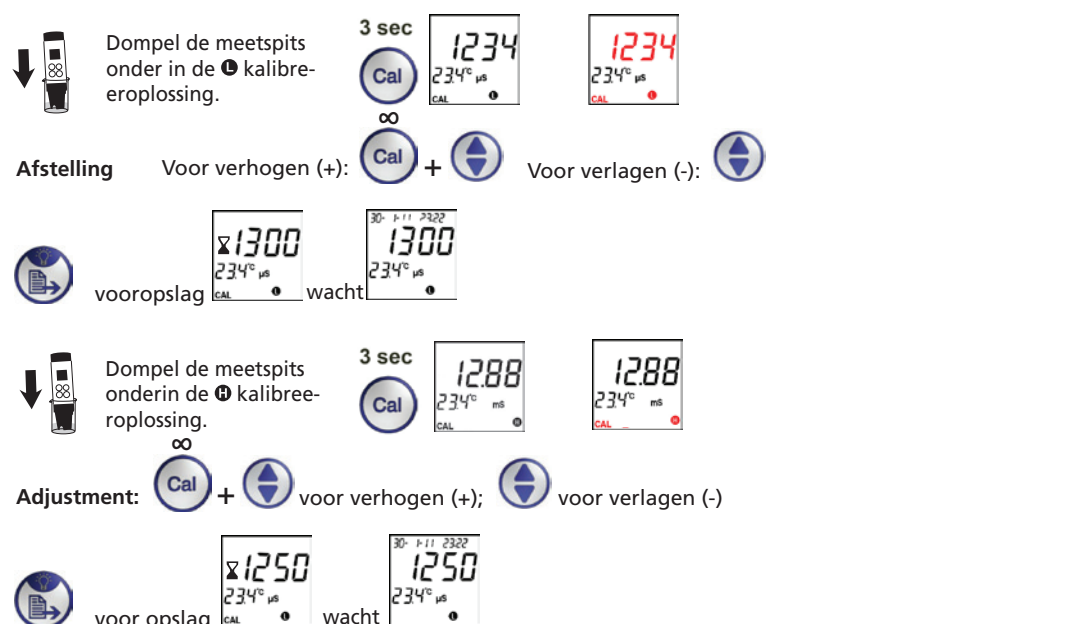

SETUP

F. Setup systeem

Tekens in **ROOD** vertegenwoordigen „Knipperende symbolen“.

Ontgrendel gegevens eerst (zie voorzijde B) vóór keuze van Menu.

- 3 sec. Terughalen gegevens ga naar I.
- 1x Kiezen buffersysteem ga naar II.
- 2x Instellen datum en tijd ga naar III.
- 3x Instellen temperatuursysteem ga naar IV.
- 4x Instellen type gegevens-/tijdsweergave ga naar V.
- Voor invoeren.

I. Terughalen gegevens

- 3 sec. Druk voor meer bestanden.
- Afsluiten

Verwijderen opgeslagen gegevens.

- 3 sec. Automatisch afsluiten

II. Kiezen kalibratiestand

- 3 sec. 1x Afsluiten

III. Datum en tijd kiezen

Kies eerst V. 'Instellen type gegevens/tijdsweergave'.

- 3 sec. 2x Afsluiten
- 24-urenklok
- 24 u Minuten Uren Jaar Maand Dag Afsluiten
- am/pm 12-urenklok
- AM PM Minuten Uren Jaar Dag Maand Afsluiten

Afstelling: voor verhogen (+); voor verlagen (-)

IV. Instellen temperatuursysteem (°C/°F)

- 3 sec. 3x Afsluiten

V. Instellen typegegevens/tijdsweergave

- 3 sec. 4x Afsluiten
- am/pm 12-urenklok of 24-urenklok

Foutcode en acties

Beschrijving	Bereik	Acties
1 Elektrode niet gemonteerd of slecht	Thermistor: 0,5k-100k	Monteer of vervang elektrode
2 Niet in gebruik		
3 Temperatuur buiten gebruik	0~60°C	Bring Sie die Lösung auf eine Temperatur im Messbereich
4 Niet in gebruik		
5 Gekalibreerde waarde buiten bereik	70%-130% (vergeleken met de standaardwaarde)	Herkalibreer of vervang de elektrode of gebruik de standaardwaarde (verwijder batterijen)
6 Geleidingsvermogen buiten bereik	<20.00 mS	Gebruik andere oplossing

SD70 Geleidingsvermogen Specificaties/eigenschappen

- 1 Werkbereik: 0-60°C, <20.00 mS
- 2 Automatische overschakeling μS en mS: μS : 1~1999 μS ; mS: 2.00~20.00mS
- 3 1- of 2-puntskalibratie voor automatische stand. Standaard gebruikte buffers: 1413 μS en/of 12,88 mS
- 4 Tot 2-puntskalibratie voor handmatige stand, +/-50% afstelbare waarde
- 5 Geleidingsvermogen resolutie: 1 μS ($\leq 1999\mu\text{S}$) en 0,01mS(2,00-20,00mS); Nauwkeurigheid: $\pm 3\%$ FS
- 6 Temperatuuresolutie: 0,1°C; Nauwkeurigheid: $\pm 1^\circ\text{C}$. Optioneel systeem $\mu\text{S}/^\circ\text{F}$
- 7 Automatische temperatuurcompensatie (2%/°C)
- 8 AnWeergave tijd en datum/stempel met 25 set gegevensopslag (niet volatiel)
- 9 22x22mm Lcd-scherm met geelgroene achtergrondverlichting
- 10 2 CR2032-batterijen
- 11 Automatische uitschakeling om batterij te sparen (8 minuten zonder activiteit)


Inhoud

- 1 Con Meter SD 70 in een robuust plastic etui met koord
- 2 batterijen
- 1 handleiding
- Bestelcode: **19 48 02**

Accessoires

- 1950017 Batterij CR 2032 (2 batterijen vereist)
- 19 48 22 Reserve-elektrode
- 384801 Beker, 100 ml

VI. Vervangen elektrode

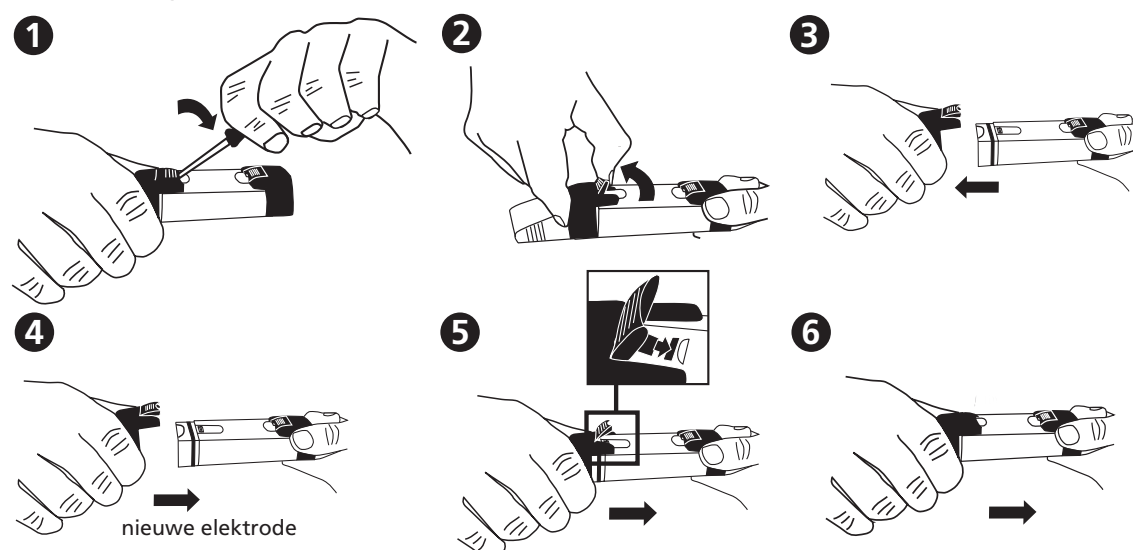

Voor handleidingen in andere talen, surf naar: www.lovibond.com